152512050081

样本

检 测 报 告

检 测 报 告

声 明

1、报告无“ CMA 章”、“云南环绿环境检测技术有限公司检测专用章” 无效。

2、报告内容涂改无效，无编制、核准、审[illegible]

3、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司对委托方提供的信息予以采信，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。

4、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司对委托方提供的信息予以采信，检测行为以及提供的检测结果报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、[illegible]

5、委托方如对本报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请复验，[illegible]

6、若项目后标注“*”，表示该项目不在本单位 CMA 认证范围内，由分包方进行检测出具检测报告。

7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

8、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。

本机构通讯资料

公司名称：云南环绿环境检测技术有限公司

地 址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区汇通发路 16 号 A1 幢 5 楼

[illegible]

检测报告

检 测 报 告

续表 2 检测项目、方法、设备和人员一览

检测项目	检测依据/标准名称	设备名称/型号	设备编号	检测人员	最低检出限
一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 非分散红外吸收法 HJ/T 44-1999	崂应 3012H 型智能烟尘（气）测试仪	HL2111	马礼剑 车杨志福	3mg/m³
	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 57-2017				
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014			李勤 马礼剑 车杨志福	

四、检测结果：

表 3-1 有组织废气检测结果一览表

检测点位	日期	序号	时间	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）	标杆流量（m³/h）
窑头◎1	2022/1/19	1	12:15-12:30	58.4	1.9	11.6	171856
		2	12:34-12:49	58.5	1.9	11.4	168912
		3	12:52-13:07	58.7	1.9	11.5	170740
		4	13:17-13:32	58.9	1.9	11.2	166084
		5	13:39-13:54	58.2	1.9	11.3	167964
		6	13:57-14:12	58.2	1.9	11.2	165926

检 测 报 告

表 3-4 有组织废气检测结果一览表

检测点位	日期	序号	时间	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）	标杆流量（m³/h）
		1	09:25-09:40	87.4	6.0	19.6	266158
		2	09:53-10:08	86.2	6.0	19.8	269388
		7	12:05-12:10	<3	348	10.9	
		8	12:14-12:19	<3	354	10.4	
		9	12:26-12:31	<3	336	10.7	

附件1：检测点位示意图



附件 2：工况表



云南环绿环境检测技术有限公司　　文件编号：HLJCT044-F 0-2021

监测期间企业生产工况记录表

企业名称		地址	云南省昆明市东川区团都镇碧谷

监测期间企业生产工况记录表

企业名称（盖章）：[illegible] 地址：[illegible]




在线比对监测：

1、

以《固定污染源废气 颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）为参比方法，对在线监控设备进行比对监测。

（2）评价标准

《固定污染源烟气（排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）为验收考核指标，评

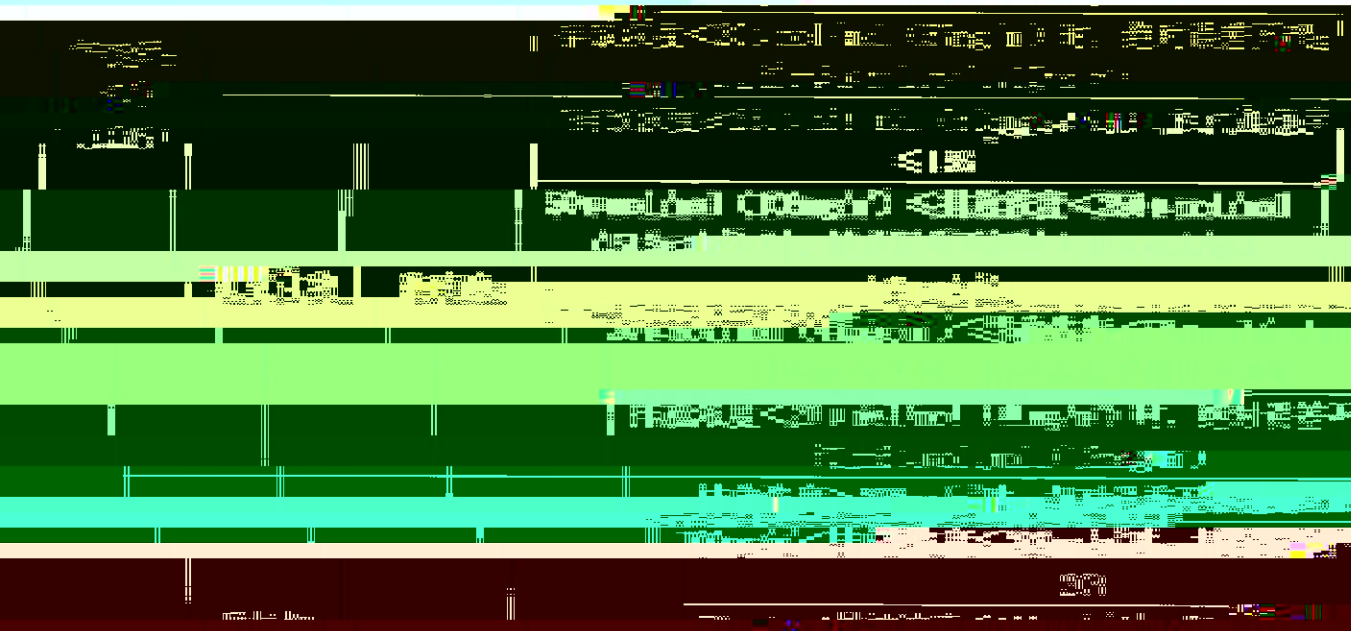

2、现场检测条件

（1）现场比对监测在一天内完成；

（2）现场监测期间生产设备运行工况稳定，固定污染源烟气连续监测系统（CEMS）运行稳定；

（3）[illegible]

系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ 76-2017）进行设置；采样位置与烟气排放连续监测系统的采样探头设置在同一水平面，避开[illegible]

3.1 监测结果

表 2　颗粒物与烟气参数（流速、温度、湿度、标杆流量）监测比对结果

监测人员：李勤、杨指然、马礼剑、车杨志福

监测地点：昆明市东川区铜都街道办事处碧谷园区

CEMS 生产厂：聚光科技（杭州）股份有限公司

CEMS 型号、编号：LSS2024（颗粒物）　　CEMS 原理：激光后散射（颗粒物）

CEMS 生产厂：[illegible]

CEMS 型号、编号：TL-HMT102（温度）　　CEMS 原理：阻容法（温度）

表 3　颗粒物与烟气参数（流速、温度、标杆流量）监测比对结果

[illegible]人员：李勤、杨治然、马礼勇、李杨志福

监测地点：昆明市[illegible]

[illegible]

	10:21-10:36	3	1.11	301.0	3.7	19.4	87.1	6.0	262861	1.9	21.4	85.8	6.1	289274	/
	[illegible]									2.1	20.8	81.6	6.2	[illegible]	
[illegible]	[illegible]									2.4	20.9	80.5	6.2	28634	
	日	11:46-12:01	6	1.48	300.0	4.8	19.7	82.9	6.0	263559	2.4	20.8	80.7	6.4	2849
[illegible]															

颗粒物浓度平均值	4.9	2.2
流速平均值（m/s）	19.6	21.1
温度平均值（℃）	85.2	83.8
湿度平均值（%）	6.0	6.2

3.2 烟气二氧化硫监测比对结果

表 4 参比方法与 CEMS 法 SO 监测比对

09:22	<3	1	/		1	09:17-	
09:48	<3	1	/		2	09:43-	
10:17	<3	1	/		3	10:12-	
10:45	<3	0	/		4	10:40-	
1:13	<3	0	/		5	11:08-1	
:41	<3	1	/		6	11:36-11	
10	<3	1	/		7	12:05-12:	
:19	<3	0	/		8	12:41-12	
:31	<3	2	/		9	12:26-12	
	<3	1	/		平均值		
值	/				数据对差的平均值的绝对		
	/				数据对差的相对误差（%		
%)	/				数据对差的标准偏差		
	/				置信系数		
	/				相对准确度（%）		
	保证值	参比方法测量值		相对误差（%）		标准气体	名称
		采样前	采样后	采样前	采样后		
	43	44	42	2.3	-2.3		SO

3.3 烟气氮氧化物监测比对结果

表 5　参比方法与 CEMS 法 NO 监测比对结果

监测人员：李勤、杨拾然、马礼剑、[illegible]

监测地点：昆明市

[illegible]区[illegible]街道[illegible]

CEMS 生产厂：聚

[illegible]科技（杭州）股份有限公司

CEMS 原理：紫外

[illegible]分法

CEMS 型号、编号

CBMS-2000　CA3216C1444

监测仪器：[illegible]

[illegible]2

参比方法[illegible]

生产厂：青岛崂山应出技术研究所

型号、编号：

[illegible]应 3012H 型、HL-211

参比方法原理：

定电位电解法


污染物名称：

氮氧化物　计量单位：mg/m³

参比方法测

[illegible]体污染源[illegible]CEMS 氮氧化物[illegible]准确度

3.4 烟气参数是监测比对的

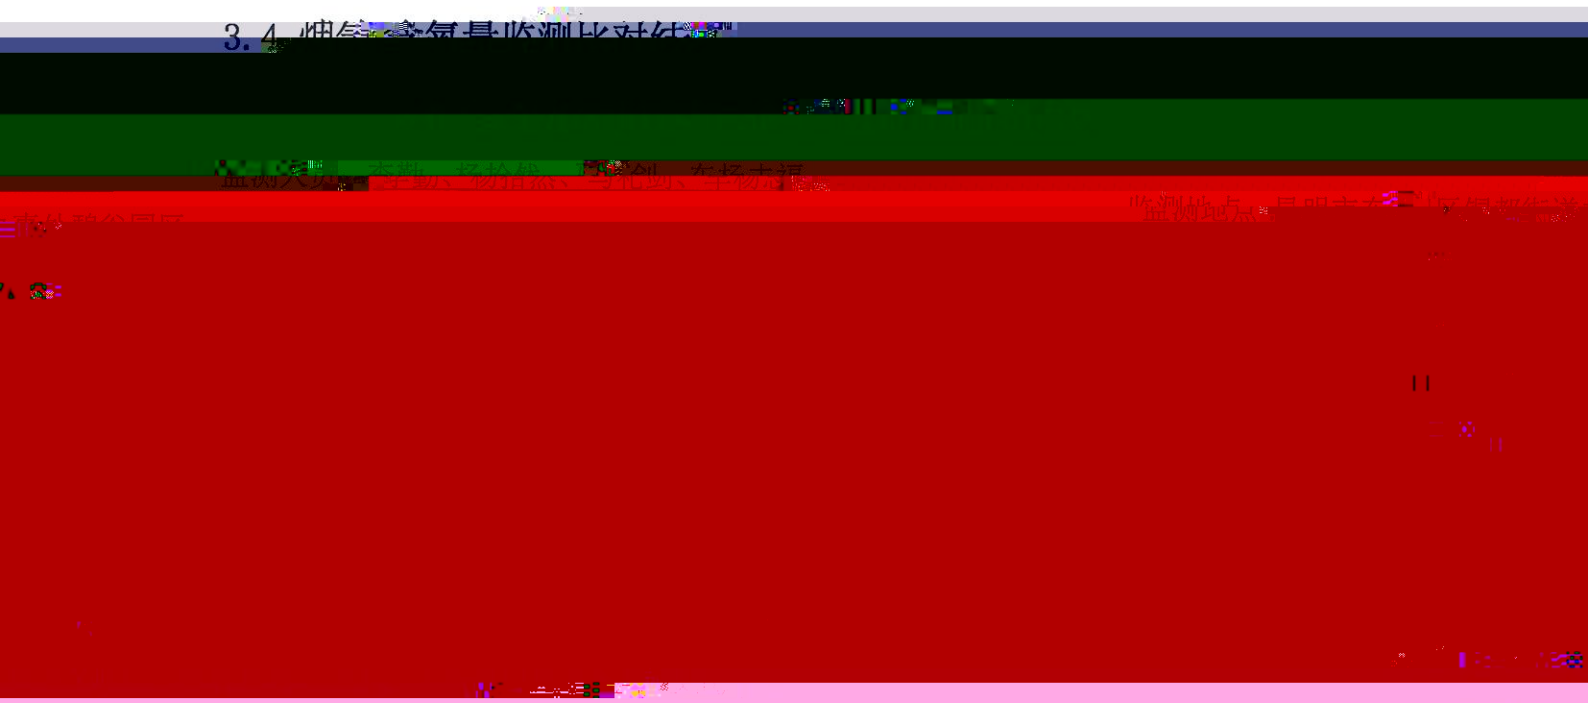

10:40-10:45	9.9	10.5	0.6	4

4、烟气排放连续监测系统比对监测结论（本结论不属计量认证范围）

监测项目	人工监测数据	自动监测数据	误差 相对（%）	误差 绝对	考核要求	比对结果
颗粒物（mg/m³）	6.0	7.2	/	1.2	≤±5mg/m³	合格
温度（℃）	58.3	57.6	/	-0.7	≤±3℃	合格
湿度（%）	1.9	1.9	/	0	≤±1.5%	合格
标杆流量（m³/h）	167789	161048	-4.0	-6724	/	/