

固定污染源烟尘烟气自动监测设备
比对监测报告

报告编号

YNZKBG20230529011-1

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第二季度比对监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

废气和空气

Type

编制

杨怀艳

Compiled by

校核

Proofread check

审核

Inspected by

签发

Approved by

签发日期: 2023 年 05 月 29 日

Approved Date

M P

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-scientific Tech. Co., LTD

报告日期

2023 年 05 月 29 日

Report Date

Y M D

deal for

invalid,

送样样
有样品

akes a
ding

所有检
影响结

f the
our
tion
ill not

rtising,

申请,

ys from
shall be

厂房
Zone,
pment

8813737

8813737

羊方法》

技术规范》

系统技术要

2) 》

三 8 月)

定下限

/m³

n³

n³

[illegible] $\mu\text{mol/mol}$

3) 时, 相

g/m^3) 时,

10

 $-6\mu\text{mol/mol}$

3) 时, 相

g/m^3) 时,

10

业工况一览表

力	监测期间生产能力	监测期间 运行情况	生产负荷
年	3746 吨/天	正常	112%

J
)
J
电阻法
温度 (C)
3.88
0.12
5.21
0.37
7.70
0.72

组法

3
11

)

35

34

71

03

45


23

公司

A019)

限公司

有限公司
： (DA019)
分有限公司
00
：
差 (d=B-A)
-0.18
-0.10
-0.08
-0.05
-0.09
-0.08
-0.07
0.11
0.08
-0.05

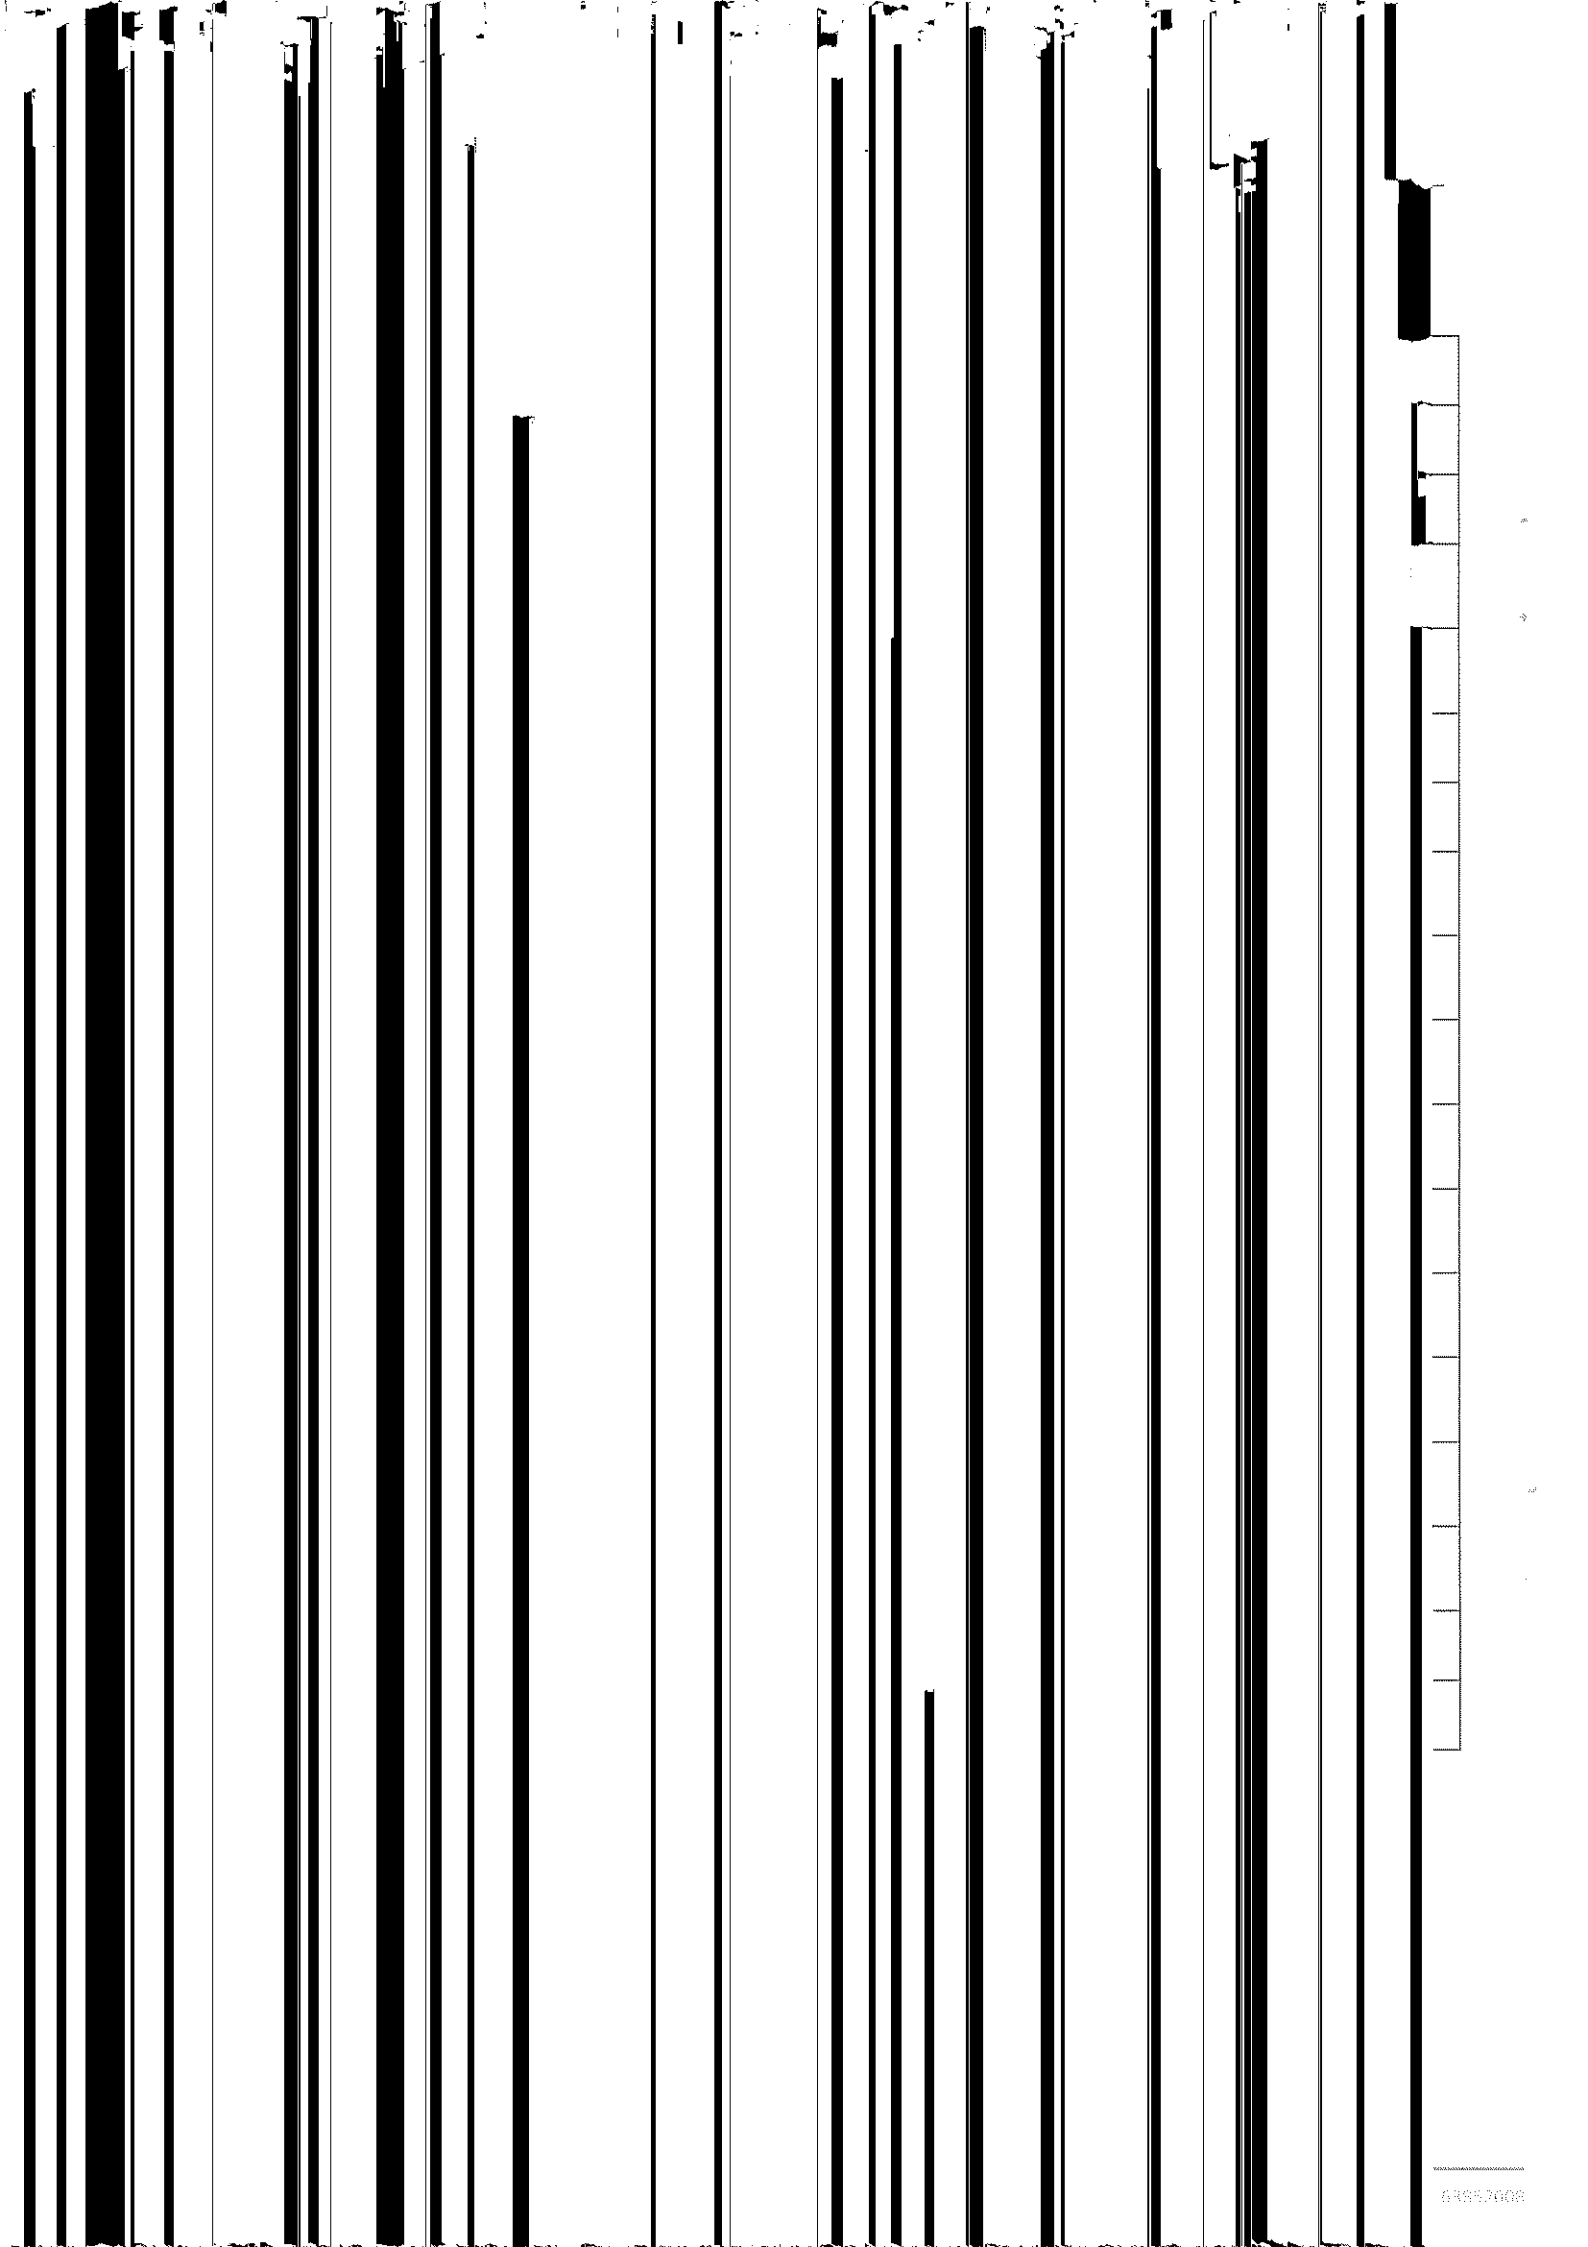

果表

日期：2023 年 05 月 16 日

	制造单位
	深圳市彩虹谷科 技有限公司
限值	结果评定
误差 ng/m ³	合格
误差 10%	合格
误差 3℃	合格
误差 .5%	合格
	方法依据
量法、	HJ 836-2017 GB/T16157-1996 及修改单
物、流速、烟温、湿度比对 7) 排放连续监测技术规范》	

